

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**MSL - 5290**

Solicitante : SOC. DE SERV. Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
Dirección : Luís Matte Larraín N°908, Las Condes, Santiago.
Atención : Luis Alegría Olate

Orden de Trabajo : 92523715

Fecha de Emisión : 2025-09-26

División Metrología - Laboratorio de Calibración Magnitud Longitud - Santiago*Servicio de Tercera Parte: Independencia de Juicio***IDENTIFICACIÓN**

Descripción : Pozómetro, Medidor de Nivel de Agua.
Marca : SOLINST CANADA LTDA.
N° de Serie : Cinta 609229 / Sensor 632352
Modelo : 101
Rango de Medida : 0 - 100 m
Resolución : 1 mm
Identificación Cliente : N/I

CONDICIONES Y FECHA DE CALIBRACION

Método : Comparación directa
Norma de Referencia : N/A
Procedimiento : PRO-DMC-411
Fecha de Calibración : **26 de septiembre de 2025**
Sello de Calibración : N° 23707

CONDICIONES AMBIENTALES

Lugar de Calibración : Lab. Calibración Área Longitud - WSS S.A.
Temperatura : (20 ± 2) °C
Humedad : (45 ± 5) %HR
Tensión : (5 ± 0,5) kgf

TRAZABILIDAD DEL PATRON

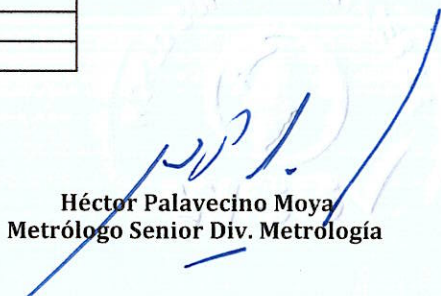
Descripción : Bloques patrones
Certificado N° : DAKkS - 0223
Trazabilidad : DICTUC

RESULTADOS (mm)

Valor Nominal	Longitud Medida	Error	Incertidumbre (k=2)
9000	9000,0	0,0	1,5
18000	18000,0	0,0	1,5
27000	27000,0	0,0	1,5
36000	36000,0	0,0	2,0
45000	44999,5	-0,5	2,0
54000	53999,0	-1,0	2,0
63000	62998,0	-2,0	2,5
72000	71997,5	-2,5	2,5
81000	80997,0	-3,0	2,5
90000	89997,0	-3,0	3,0
99000	98997,0	-3,0	3,0
100000	99997,0	-3,0	3,0

El presente Certificado de Calibración no debe ser reproducido en forma parcial, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del Laboratorio de Metrología de WSS S.A.

"Fin de Certificado de Calibración"


Héctor Palavecino Moya
Metrólogo Senior Div. Metrología