

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
MSL - 5275

Solicitante : SOC. DE SERV. Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

Dirección : Luis Matte Larraín N°908, Las Condes, Santiago.

Atención : Luis Alegría Olate

Orden de Trabajo : 92523715

Fecha de Emisión : 2025-09-16

División Metrología - Laboratorio de Calibración Magnitud Longitud - Santiago*Servicio de Tercera Parte: Independencia de Juicio***IDENTIFICACIÓN**

Descripción : Pozómetro, medidor de nivel de agua
Marca : SOLINST CANADA LTDA
N° de Serie : 363937 / sensor 602318
Modelo : 101
Rango de Medida : 0 - 30 m
Resolución : 1 mm
Identificación Cliente : N/I

CONDICIONES Y FECHA DE CALIBRACIÓN

Método : Comparación Directa
Norma de Referencia : N/A
Procedimiento : PRO-DMC-411
Fecha de Calibración : **2025-09-12**
Sello de Calibración : N° 22099

CONDICIONES AMBIENTALES

Lugar de Calibración : Lab. Calibración Área Longitud - WSS Chile S.A.
Temperatura : (20 ± 2) °C
Humedad : (50 ± 5) %HR
Tensión : (5 ± 0,5) kgf

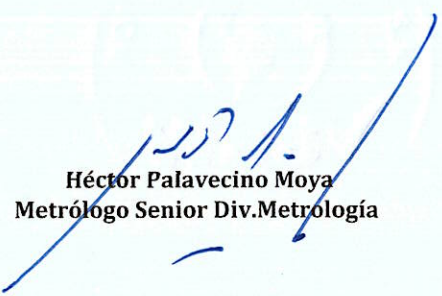
TRAZABILIDAD DEL PATRON

Descripción : Bloques Patrones
Certificado N° : 1633173
Trazabilidad : DICTUC

RESULTADOS (mm)

Valor Nominal	Longitud Medida	Error	Incertidumbre (k=2)
3000	3000,0	0,0	1,5
6000	6000,0	0,0	1,5
9000	9000,0	0,0	1,5
12000	12000,0	0,0	1,5
15000	15000,0	0,0	1,5
18000	17998,5	-1,5	2,0
21000	20999,0	-1,0	2,0
24000	23999,5	-0,5	2,0
27000	26999,5	-0,5	2,0
30000	29999,5	-0,5	2,0

El presente Certificado de Calibración no debe ser reproducido en forma parcial, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del Laboratorio de Metrología de WSS S.A.


Héctor Palavecino Moya
Metrólogo Senior Div.Metrología

"Fin de Certificado de Calibración"