

Multiparámetro:

WTW Multi 3430

Serie:

9480679

Fecha:

14.06.2026

1-. pH

Serie electrodo: 4252106017

Buffer	Lote	Después de ajustar		Término jornada			Verificación	
		lectura	temp	lectura	temp	hora	Buffer	valor
4,01	10.28-1	4.010	14.7	4,074	15,0	20:02	4,01	
7,01	10.28-1	7.000	13.6	7.089	14,5	20:00	7,00-7,01	
10,01	10.27-2	10.011	13.5	10.088	15,3	20:06	10,01	

Rangos aceptación	
4,01	3.90 - 4.10
7,01	6.90 - 7.10
10,01	9.90 - 10.10

Para WTW agregar:

Punto cero [mV]	1.3
Pendiente [mV/pH]	-58.2

Rango de aceptación

-25	25
-61,0	-56,0

Hora calibración

10:46

Registro de calibración

*	**	***
		✓

2-. Conductividad Eléctrica (CE):

Serie electrodo: 22270843

Buffer µS/cm	Lote	Después de ajustar		Término jornada			Verificación	
		lectura	temp	lectura	temp	hora	Buffer	valor
1413	02.28-1	1450	12.6	1460	15,8	20:16	1413	
5000							5000	
12880							12880	
80000							80000	
111800	116 900	13.8	13,2	116,800	16,2	20:10	111800	

Rangos aceptación	
1413	1342 - 1484
5000	4750 - 5250
12880	12160 - 13440
80000	76000 - 84000
111800	106210 - 117390

Para WTW agregar:

Constante celular	0.474
-------------------	-------

Rango de aceptación

0,450 cm ⁻¹	0,500 cm ⁻¹
------------------------	------------------------

Hora calibración

10:50

Registro de calibración

*	**	***
		✓

3-. Oxígeno Disuelto (OD)

Hora: 10:58

Serie electrodo: 25041016

Buffer	Lote	Verificación	
		0%	100%

Estándar	0	100
Rango	<0.05mg/L	> 95%

Para WTW agregar:

Pendiente relativa	0,95
--------------------	------

Rango de aceptación

0,9	1,1
-----	-----

Registro de calibración

*	**	***
		✓

4-. Potencial Redox (ORP)

Hora:

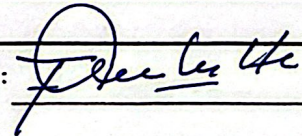
Serie electrodo:


Patrón	Lote	Después de ajustar		Término jornada			Verificación	
		lectura	temp	lectura	temp	hora	Buffer	valor
240 mV							240 mV	

Rangos aceptación	
240 mV	228 - 252

5-. Observaciones:

Responsable calibración: Fernando Rocoelo H.

Firma: 

Supervisor: 

Firma:

Fecha validación: 14.06.2026